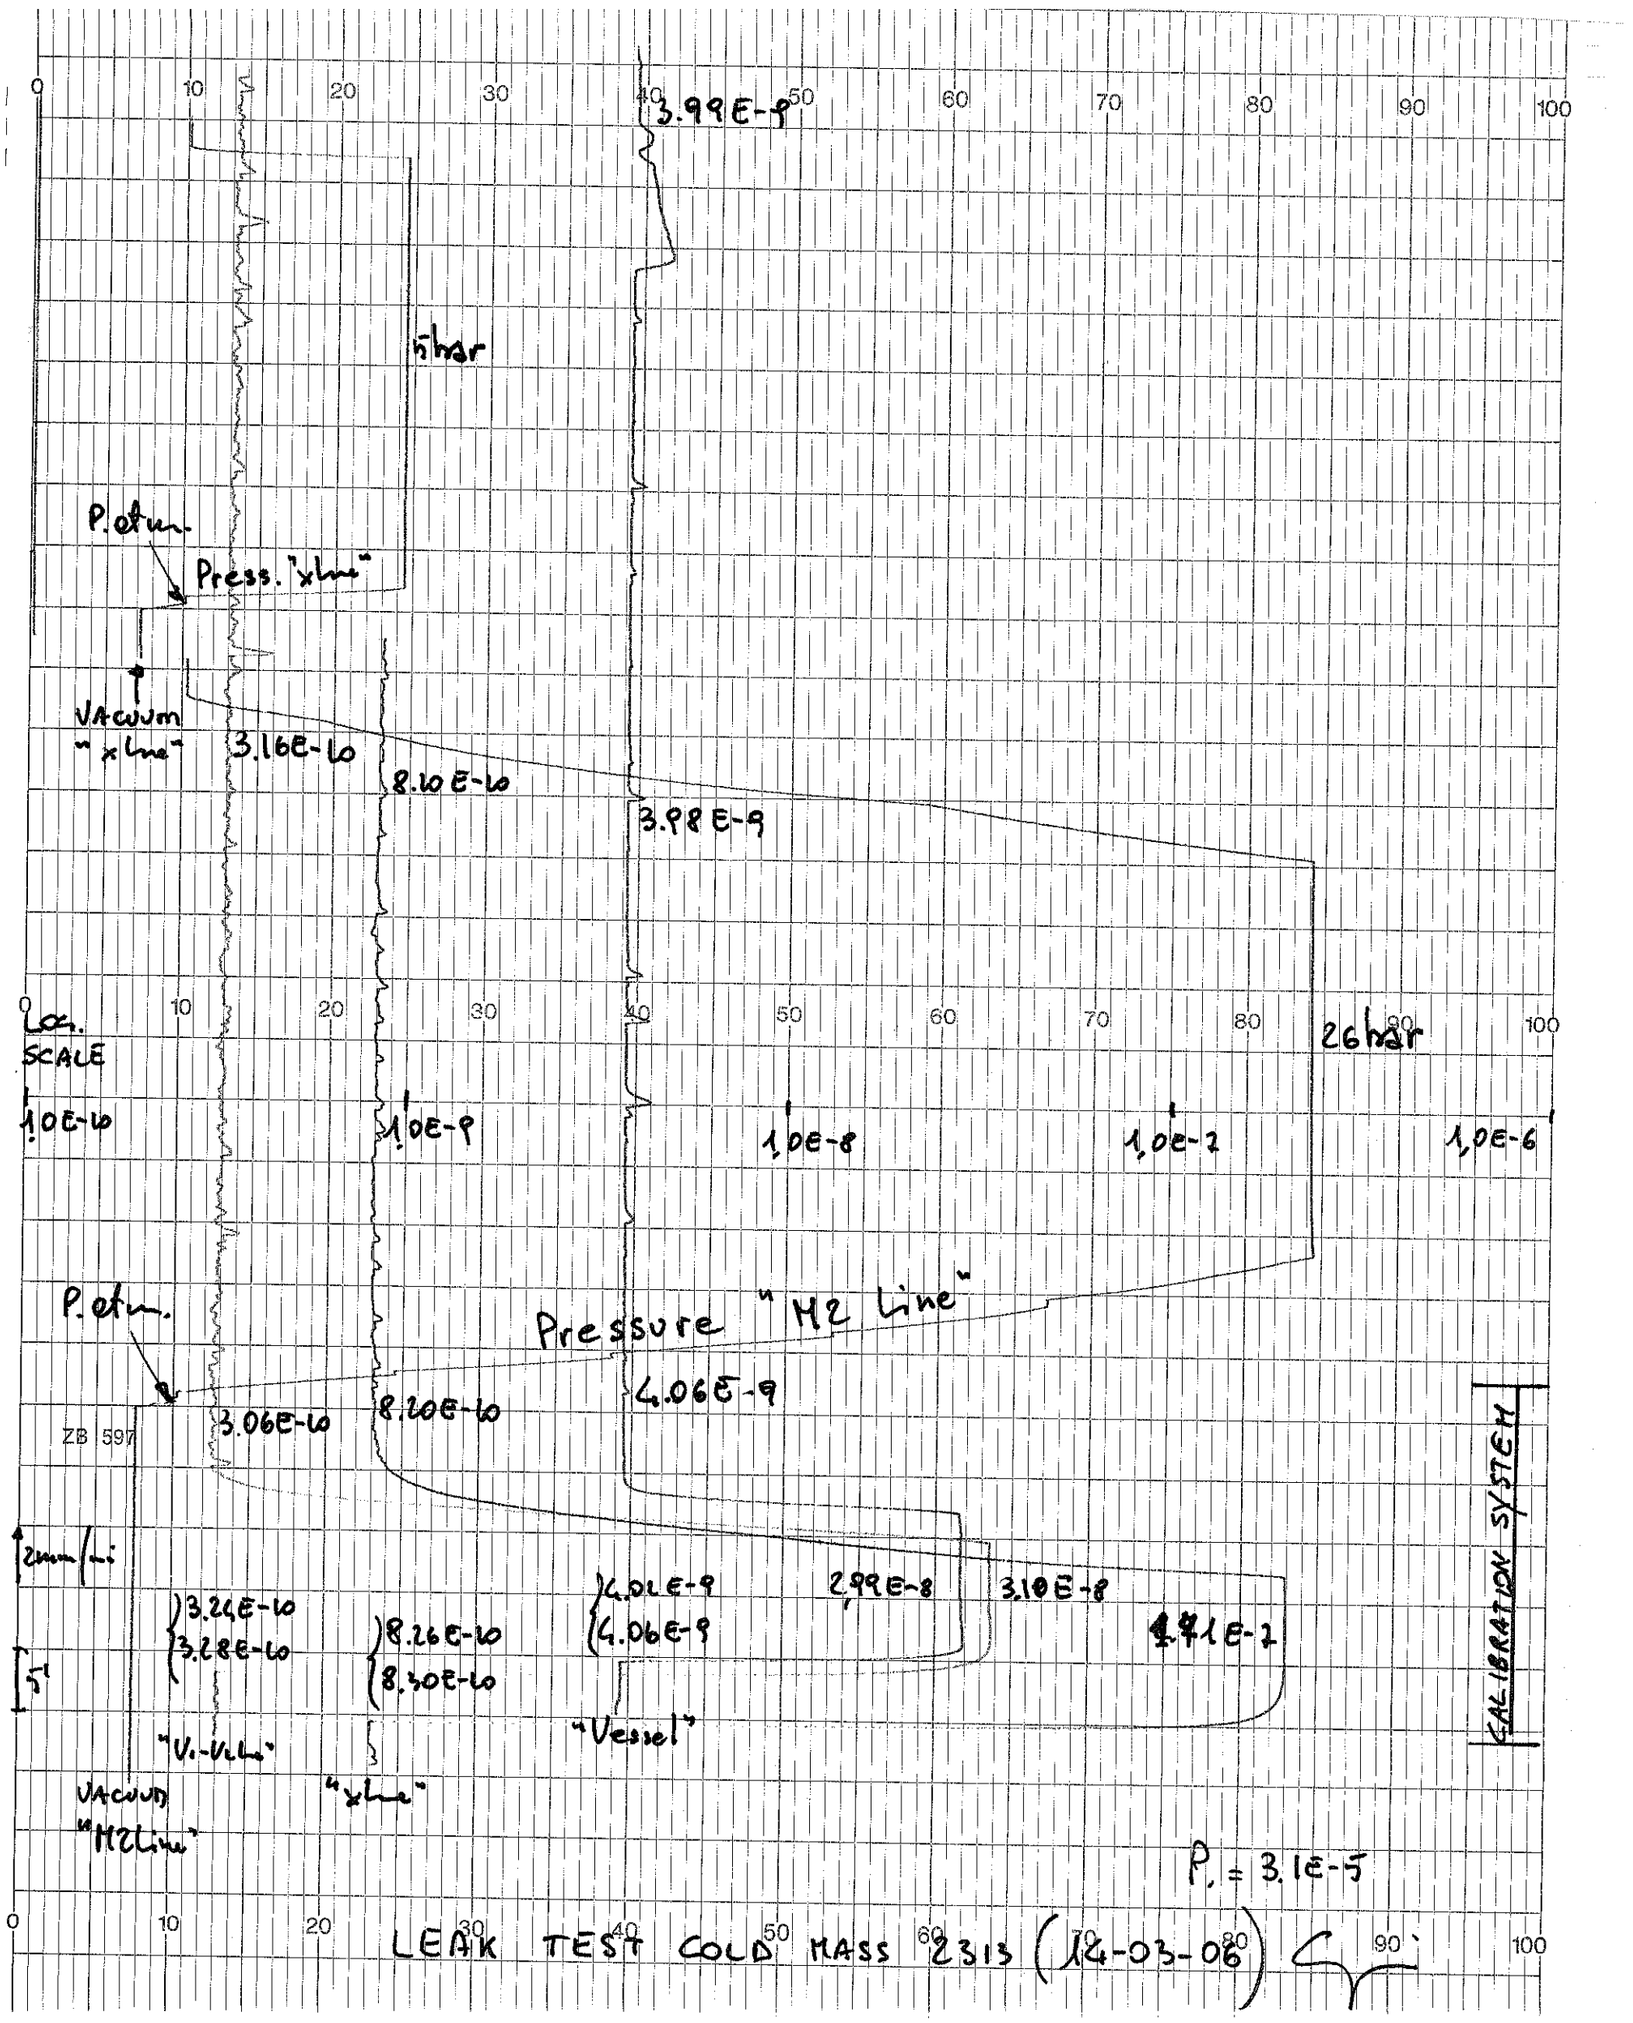
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3.99E-9
5bar
P.atm.
Press. "x line"
VACUUM "x line"
3.16E-10
8.10E-10
3.98E-9
Log. SCALE
1.0E-10
1.0E-9
1.0E-8
1.0E-7
1.0E-6
26bar
P.atm.
Pressure "H2 Line"
4.06E-9
ZB 597
3.06E-10
8.20E-10
2mm
3.24E-10
3.28E-10
8.26E-10
8.30E-10
4.01E-9
4.06E-9
2.99E-8
3.10E-8
4.41E-7
5'
"V.-V. Line"
"Vessel"
"x Line"
VACUUM "H2 Line"
CALIBRATION SYSTEM
P. = 3.1E-5
LEAK TEST COLD MASS 2313 (14-03-06)